


Röhrenprüfgerät RPG 70

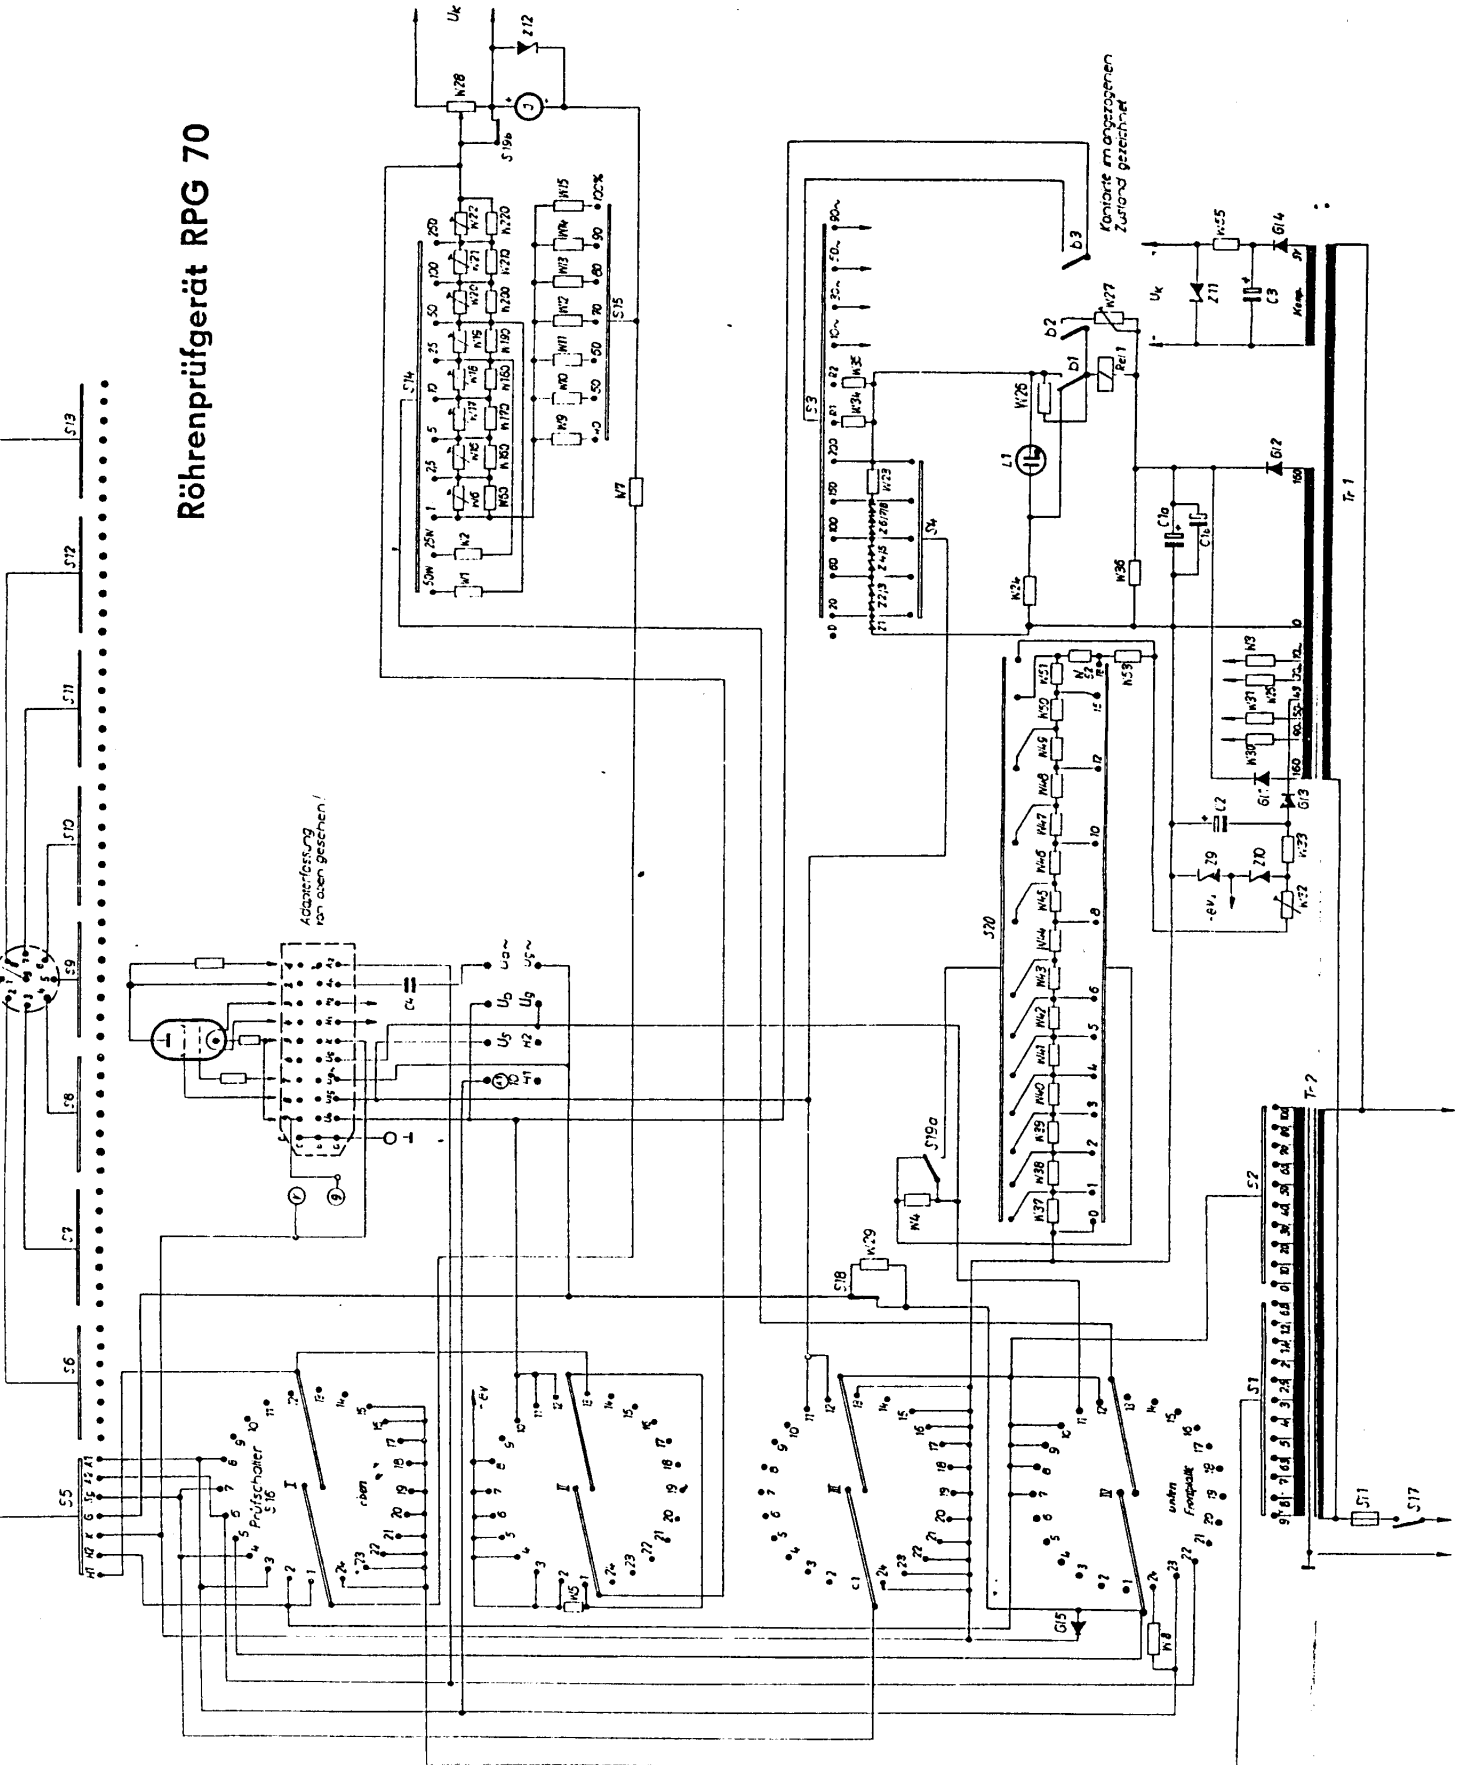

Adapterfassung
von oben gesehen!

Fantare im angelegten
Zustand getrennt

T-2

T-1